

Het Syntein – PT Medical aanbod februari 2026

Vitalograph Pneumotrac spirometer + Spirotrac 6 software

Zoals jullie wellicht weten, gaat de spirometer van Vyair uit de roulatie. De software wordt niet meer ondersteund na 2026. Bij defect kunnen geen onderdelen of software-updates meer geleverd worden.

Met PT Medical hebben wij een kortingsafspraken kunnen maken. Tot en met maart 2026 geldt een korting van **20% op de spirometer**. Vanaf **1 april 2026** geldt een korting van **15%**.

Wanneer meerdere praktijken gezamenlijk overstappen, kunnen de **instructiekosten worden gedeeld**.

Normale prijs:	€ 1.850,- excl. btw
Syntein prijs tot 1 april (20% korting)	€ 1.480,- excl. btw
Syntein prijs vanaf 1 april	€ 1.572,- excl. btw
Installatie op afstand zonder instructie per praktijk	€ 99,- excl. BTW
Instructie op de praktijk evt. op meerdere PC's per praktijk	€ 550,- *excl. BTW
Korting gezamenlijke instructie Wanneer een aantal praktijken besluit tot gelijktijdig overgaan, dan kan de instructie gezamenlijk gedaan worden. Bij 3 installaties op 1 dag €185,- per praktijk. En bij 2 installaties op 1 dag €275,- per praktijk. Syntein maakt met de deelnemende praktijken een planning zodat PT Medical de installaties op één dag kan doen. En er wordt een gezamenlijke instructie gepland.	

IJkspuiten

De ijkspuiten die op de Carefusion passen, zijn ook geschikt voor de Vitalograph.

Onderhoud

Het onderhoudscontract van Syntein blijft van toepassing op de Vitalograph Pneumotrac spirometer. Huisartsenpraktijken kunnen kosteloos jaarlijks hun spirometer opsturen naar PT Medical voor preventief onderhoud. Eventuele reparaties die nodig zijn, betaalt de huisartsenpraktijk na overleg met de praktijk zelf. Voor [hier](#) voor de handleiding voor het aanvragen van een servicecontract. De factuurgegevens kunnen opgevraagd worden bij Syntein.

NB. Koppelingen

- Er is momenteel een werkende koppeling met zowel Medcom als Chipsoft; Voor CGM is de koppeling deels operationeel en er komt in het eerste kwartaal een update die dit verder zal verbeteren;
- Ook voor Sanday komt er in het eerste kwartaal een update die de koppeling mogelijk maakt;
- De exacte status voor MicroHis is nog niet bekend. Er wordt aangeraden contact op te nemen met hun ontwikkelaar René Caspers voor meer informatie.

Werkwijze bestellen


Rechtstreeks met kortingscode (geen gezamenlijke instructie)

- De praktijk kan rechtstreeks op de website van PT Medical een bestelling plaatsen en de kortingscode van Syntein invoeren (z.o.z.): **Syntein2024**;
- Met deze kortingscode heeft de klant 20% korting op de spirometer en op de Vitalograph bacteriefilters.

Via Syntein en de praktijk neemt deel aan een gezamenlijke instructie

- Bestelling doet Syntein. Syntein zal de praktijkgegevens doorgeven aan PT Medical;
- Syntein maakt een planning met de praktijken uitgaande van 2 à 3 per dag;
- PT Medical stuurt de praktijk rechtstreeks de factuur.

Bijlage bestellen

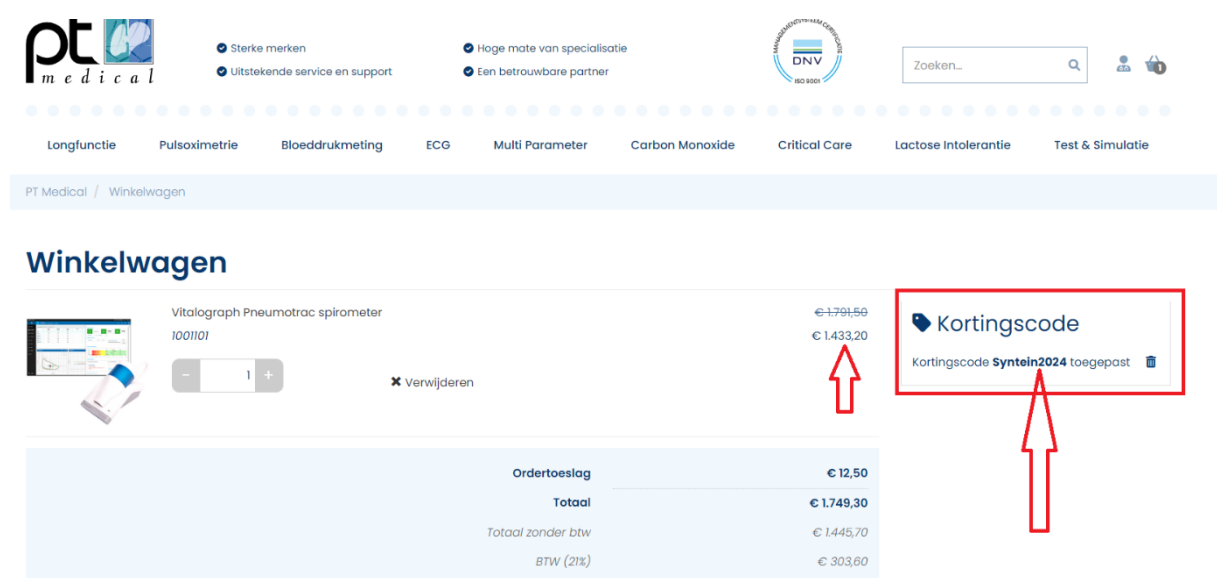

The screenshot shows the PT Medical website interface. At the top, there is a navigation bar with the PT Medical logo, several service icons (Sterke merken, Uitstekende service en support, Hoge mate van specialisatie, Een betrouwbare partner), a DNV logo, a search bar, and user icons. Below this is a horizontal menu with categories: Longfunctie, Pulsoximetrie, Bloeddrukmeting, ECG, Multi Parameter, Carbon Monoxide, Critical Care, Lactose Intolerantie, and Test & Simulatie. The main content area is titled 'Winkelwagen' (Shopping Cart). It displays a 'Vitalograph Pneumotrac spirometer 1001101' with a quantity of 1. To the right of the product, a price reduction is shown: from €1.791,50 to €1.433,20. A red box highlights a 'Kortingscode' (Discount Code) field where 'Syntein2024' has been applied. Below the product, a summary table shows the order total: 'Ordertoeslag' €12,50, 'Totaal' €1.749,30, 'Totaal zonder btw' €1.445,70, and 'BTW (21%)' €303,60. Red arrows point from the discount code box to the price reduction and the final total.

Vorbereiding installatie

Voordat de software geïnstalleerd wordt, is het volgende van belang:

1. Indien je een ICT-partner hebt, verzoeken wij je deze vooraf **te informeren**, zodat de **Spirotrac Spirometrie-software** en een **SQL-database** op de betreffende pc kunnen worden geïnstalleerd.
2. Voor het uitvoeren van de software-installatie hebben wij **volledige Windows-administratorrechten** nodig op de betreffende computers.